


- Large - Black
Grand - Noir
Gross - Schwarz
Largo - Negro
- Small - White
Petit - Blanc
Klein - Weiss
Pequeño - Blanco
- ⏻ Stand - By
Attente
Bereitschaft
En Espera
- ⏚ Frame or Chassis
Masse
Chassis
Soporte o Chasis
- ⚡ X-Ray Tube
Tube Radiogène
Röntgenröhre
Tubo de Rayos X
- ⚡ Radiation Filter or Filtration
Filtre de rayonnement
Filterung
Filtración de Radiación

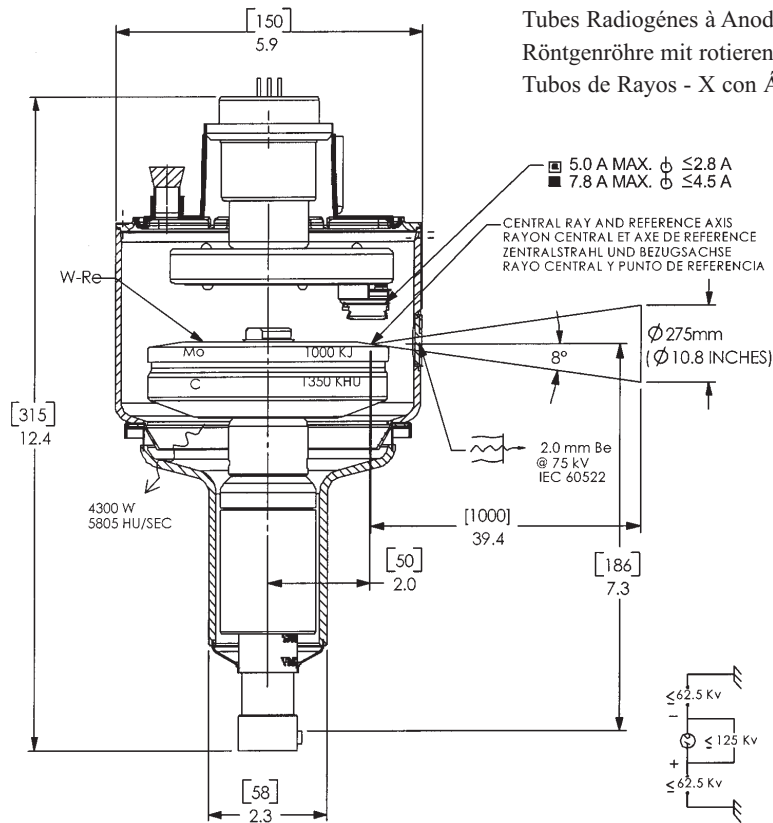

Tubes Radiogènes à Anode Tournante
 Röntgenröhre mit rotierender Anode
 Tubos de Rayos - X con Ánodo Giratorio

Note: Document originally drafted in the English language.

Product Description	Description du Produit	Produktbeschreibung	Descripcion del Producto
<p>The SG-1560 is a 4.64" (118 mm) 125 kV, 1.0 MJ (1.35 MHU) maximum anode heat content, rotating anode insert. This insert is specifically designed for general radiography, cineradiography, digital and film screen angiography procedures. The insert features a 8° rhenium-tungsten facing on molybdenum with a graphite backed target and is available with the following nominal focal spots:</p> <p style="text-align: center;">0.4 - 0.8 IEC 60336</p> <p>Nominal Anode Input Power Small - 30 kW IEC 60613 Large - 82 kW IEC 60613 For the equivalent anode input power of 400 Watts</p> <p>The small focal spot (0.4) has grid control capability at 2000 V.</p>	<p>Le tube SG-1560, à anode tournante de 118 mm, (4,64 pouces), 125 kV, avec une capacité calorifique maximale de 1,0 MJ (1,35 MUC) spécialement conçue pour les procédures radiographie générale, cinéradiographie et angiographie numériques et sur film. L'tube est pourvu d'une anode avec pente de 8° en rhenium - tungstène sur une base de molybdène et avec un doublage de graphite. Il est disponible avec les foyers suivantes:</p> <p style="text-align: center;">0,4 - 0,8 CEI 60336</p> <p>Puissance anodique nominale de l'anode Petit foyer - 30 kW CEI 60613 Grand foyer - 82 kW CEI 60613 Pour la puissance anodique d'équilibre thermique de 400 Watts</p> <p>Les petit foyer (0.4) ont une fonction de commande de grille à 2000 V.</p>	<p>Die SG-1560 ist eine 4.64" (118 mm) Doppelfokus Drehanoden-Röntgenröhre, mit einer Anoden Wärmespeicherkapazität von 1.0 MJ (1.35 MHU) und einer max. Spannungsfestigkeit von 125 kV. Die Röhre ist spezielle für den Radiographie-, Röntgenkinematographie-, digitale und Filmangiographieverfahren entwickelt. Der rückseitig graphitbeschichtete Rhenium-Wolfram- und Molybdän Anodenteller besitzt einen Winkel von 8°. Folgende Brennfleckkombination ist lieferbar:</p> <p style="text-align: center;">0.4 - 0.8 IEC 60336</p> <p>Nominale Anodenbezugsleistung Klein - 30 kW IEC 60613 Gross - 82 kW IEC 60613 Gilt bei einer Aequivalent - Anodenleistung von 400 Watts</p> <p>Der kleine brennfleck (0.4) ist mit Gittersteuerungsfunktion ausgestattet an 2000 V.</p>	<p>El SG-1560 es un tubo de ánodo giratorio de 118 mm (4.64"), 125 kV, 1.0 MJ (1.35 MHU) diseñado específicamente para procedimientos generales de radiografía, cineradiografía, digital, y angiografía con película de pantalla. El blanco emisor es una combinación de renio, tungsteno y molibdeno con grafito en la parte posterior con un rayo central de 8 grados. Disponible con las siguientes combinaciones de marcas focales:</p> <p style="text-align: center;">0.4 - 0.8 IEC 60336</p> <p>Potencia nominal de entrada del anodo Foco fine - 30 kW IEC 60613 Foco grueso - 82 kW IEC 60613 Para una potencia equivalente del anodo de 400 Watts</p> <p>El pequeño marca focal (0.4) tiene capacidad del control de rejilla en 2000 V.</p>



Manufactured by Varian Medical Systems
Fabrique par Varian Medical Systems
Hergestellt von Varian Medical Systems
Fabricado por Varian Medical Systems

Specifications subject to change without notice.
Spécifications susceptibles d'être modifiées sans préavis.
Technische Daten ohne Gewähr.
Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

3 Ø Constant Potential

50/60 Hz

Abaques de Charge pour Pose Unique CEI 60613
Brennfleck - Belastungskurven IEC 60613
Diagramas de Exposición Radiográfica IEC 60613

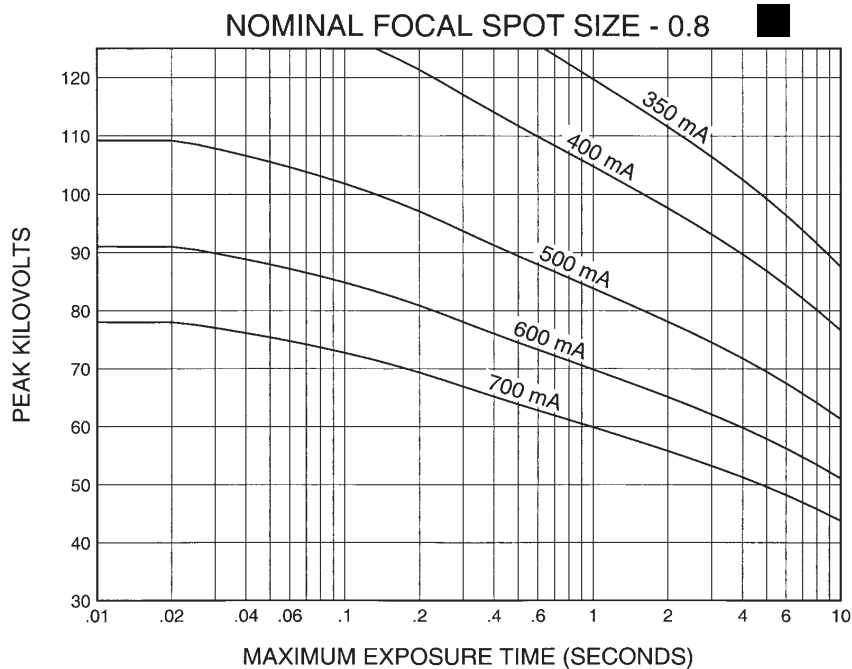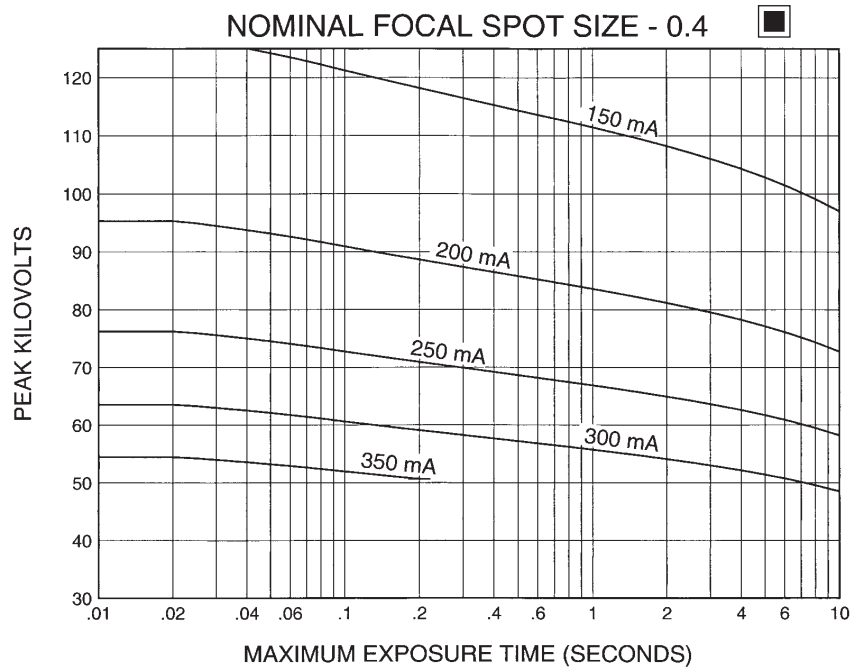

Nominal anode input power for the anode heat content 40%. IEC 60613

Puissance calorifique nominale de l'anode: 40%, CEI 60613



Thermische Anoden bezugsleistung für eine speicherung von 40%. IEC 60613

Aproximadamente el poder de penetracion para obtener un almacenaje de calor del anodo de 40%. IEC 60613

3 Ø Constant Potential

150/180 Hz

Abaques de Charge pour Pose Unique CEI 60613
Brennfleck - Belastungskurven IEC 60613
Diagramas de Exposición Radiográfica IEC 60613

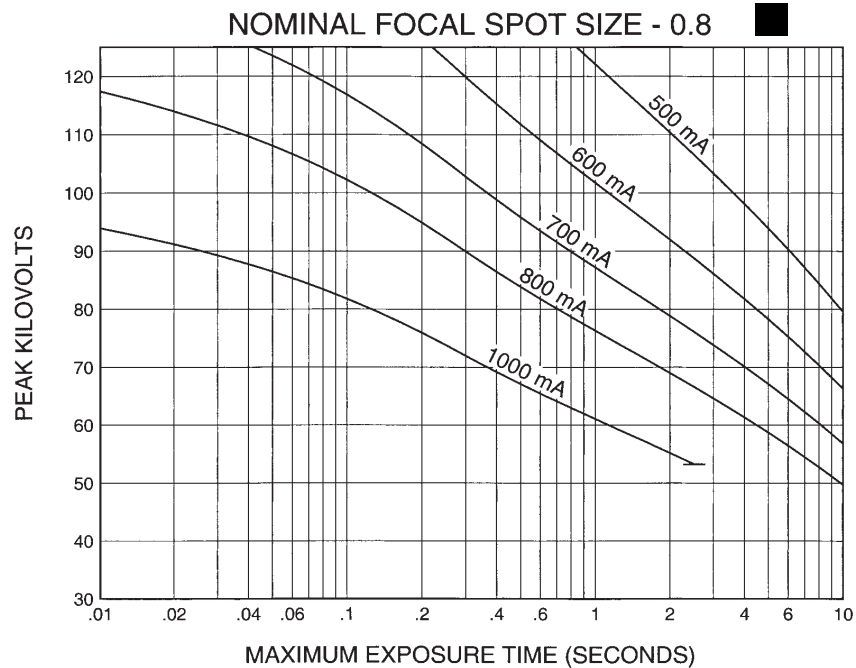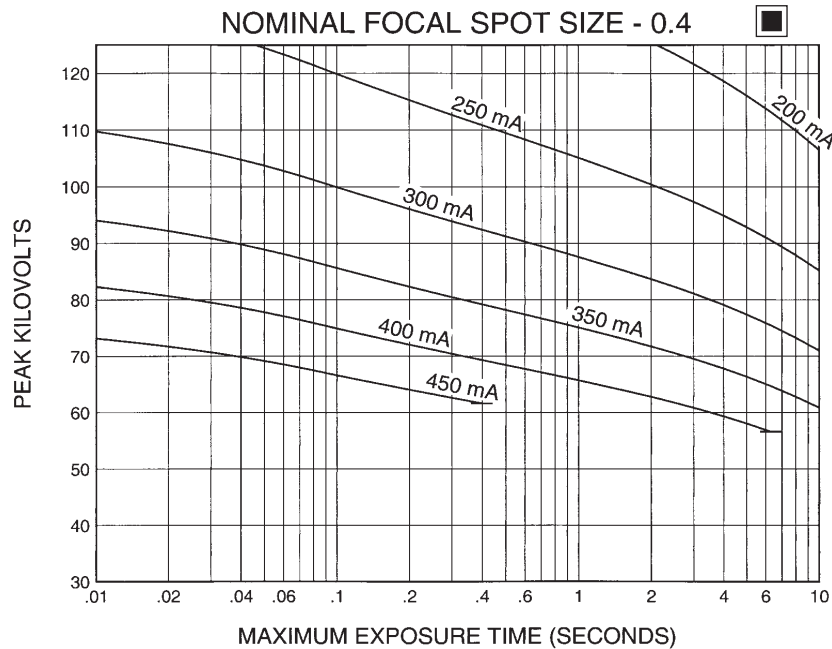

Nominal anode input power for the anode heat content 40%. IEC 60613

Puissance calorifique nominale de l'anode: 40%, CEI 60613

Thermische Anoden bezugsleistung für eine speicherung von 40%. IEC 60613

Aproximadamente el poder de penetracion para obtener un almacenaje de calor del anodo de 40%. IEC 60613

CINERADIOGRAPHIC RATINGS

HOW TO USE CINERADIOGRAPHIC CHARTS

General: With the Cineradiographic rating chart we can determine the maximum allowable kW of the Cine pulse, or with a given kW determine maximum time in seconds the Cine run can progress.

The Most common way of using the charts is to determine maximum time of any expected Cine run and maximum duty factor. With a known duty factor and Cine run time the kW can easily be determined.

Definition of Terms

Time in seconds: Total time of one Cine run, usually 5 to 12 seconds.

Duty Factor in Percent (DF%): Actual time during one second the x-ray tube is producing x-rays. If we select a 4 msec pulse width and 60 exposures per second the x-ray tube will be producing x-rays for a total of 240 msec each second or 24% of the time. The higher the DF number, the more load placed on the x-ray tube.

Peak Pulse Power: Peak energy in watts of any one Cine Pulse. Can be any combination of kV and mA allowed by Radiographic and Filament Emission curves.

Example: 80 kV at 400 mA equals

$$80,000 \text{ V} \times 0.4 \text{ A} = 32,000 \text{ W or } 32 \text{ kW}$$

USING THE CINE RATING CHARTS:

SG-1560 150/180 Hz 3 Phase 0.8 Focal Spot

Example: Determine maximum kW allowed with the following known factors:
Maximum Pulse Width 4 msec
Exposures per Second 60
Maximum Cine Run Time ... 10 seconds

Calculate Duty Factor: (DF%)

$$\text{DF\%} = \frac{\text{Pulse Width (msec)} \times \text{Frames per Second}}{10}$$

$$\text{DF\%} = \frac{4 \text{ msec} \times 60 \text{ exp/sec}}{10} = \frac{240}{10} = 24\%$$

Refer to Rating Chart SG-1560 150/180 Hz 3 Phase 0.8 Focal Spot:

At bottom of chart find 10 second line. Move vertically to intersection with 24% DF curve. Make a horizontal reference to left side of rating chart and note kW rating of 61 kW.



kW = kV x mA. The kW of the exposure can be any combination of mA and kV allowed by the Radiographic and Filament Emission Charts.

The Cine rating charts are usable to 100% anode heat storage. Exceeding 100% anode heat storage will cause anode track erosion with high risk of tube destruction.



3 Ø Constant Potential

Abaques de Cinèradiographie CEI 60613
Belastungskurven für den Kinobetrieb IEC 60613
Diagramas de Exposición Cineradiográfica IEC 60613

50/60 HZ

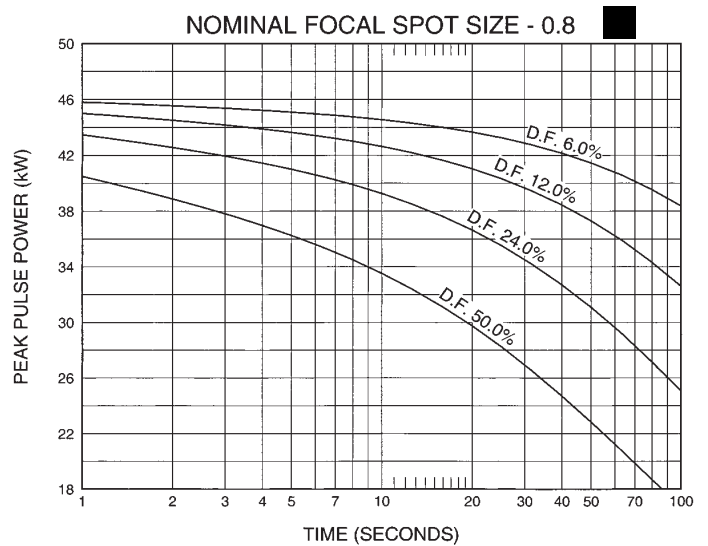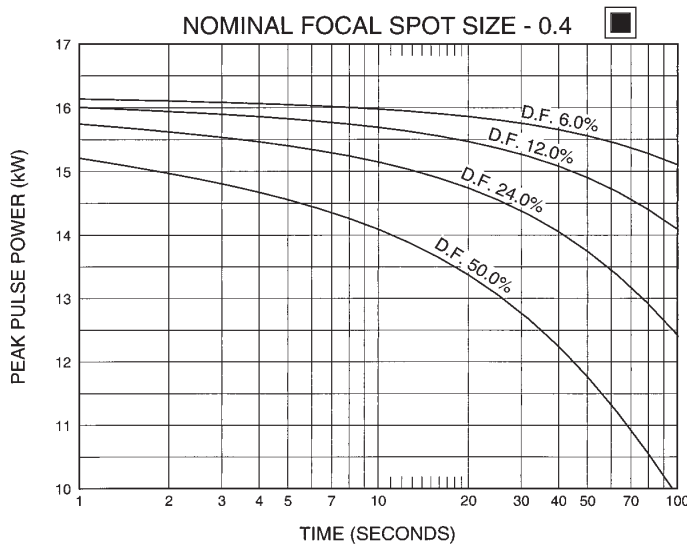

150/180 HZ

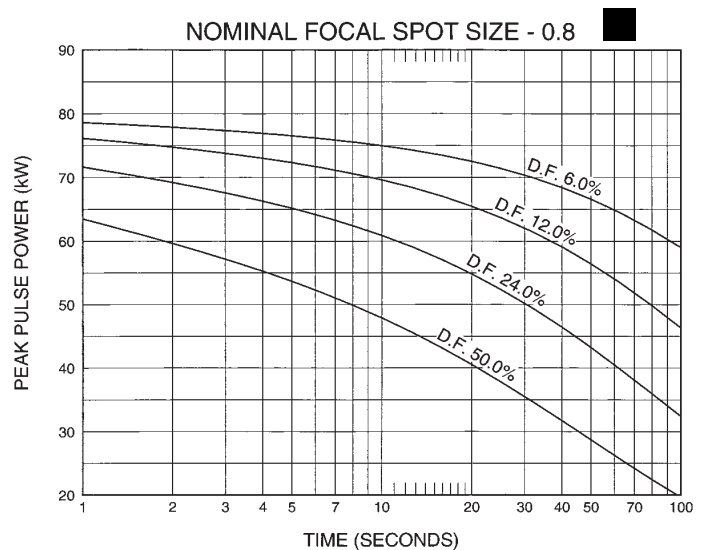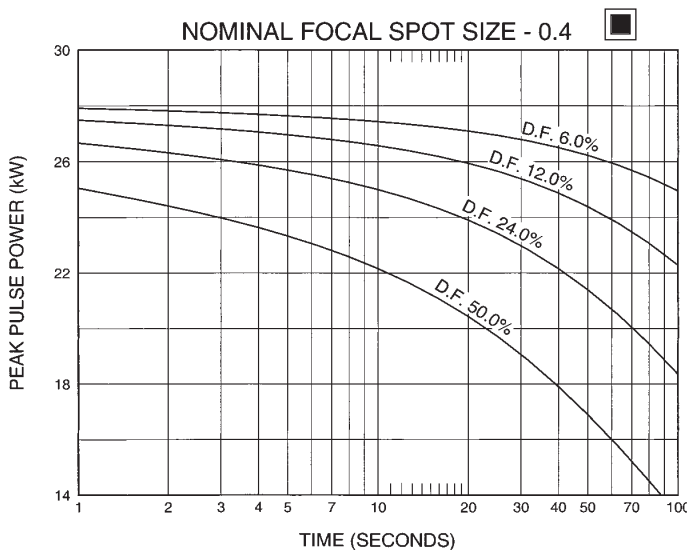

Nominal anode input power for the anode heat content 70%. IEC 60613

Puissance calorifique nominale de l'anode: 70%, CEI 60613

Thermische Anoden bezugsleistung für eine speicherung von 70%. IEC 60613

Aproximadamente el poder de penetración para obtener un almacenaje de calor del anodo de 70%. IEC 60613

ANGIOGRAPHIC RATINGS

HOW TO USE ANGIOGRAPHIC CHARTS

General: Serial Radiography puts a severe demand on the x-ray tube due to the large number of exposures made in rapid succession. Intervals between exposures are fixed and so short that it is not possible for the anode track to cool to any extent during the exposure series. Therefore, the temperature of the anode track increases from exposure to exposure. The kW values used in the angiographic charts have been determined to prevent damage to the anode. The angiographic rating charts are usable to 100% anode heat storage. Exceeding 100% anode heat storage will cause anode track erosion with high risk of tube destruction.

Definition of Terms

Number of Exposures in Series: The number of exposures made in succession or the number of exposures made during one contrast injection.

Exposure Rate: The number of exposures made per second. For a series of exposures where the exposure rate changes, it must be assumed that all exposures will be made at the maximum rate. For example, if during a series 10 exposures will occur at one per second and 30 exposures at 4 per second, use the kW ratings in the 40 exposure column at 4 per second rate.

Exposure Time: Time in seconds of each exposure.

USING THE CHARTS:

Determine the number of exposures in Series: With cut film angiography the number of exposures are known, however in Digital Angiography the number of exposures commonly are not known. When determining the number of exposures, assume worst case or past history.

Note: Most angiographic x-ray tubes fail from underestimating the number of exposures made in a series.

Determine kW of each exposure in Series: Referring to chart —find block under “Number of Exposures in Series” that is greater than or equal to expected number of exposures in Series. On left side directly opposite this block under “Exposure Rate per Second” column, select maximum rate per second that will be used for the exposure series. At the intersection of exposure rate and exposure time in seconds, find maximum kW allowed for each exposure.

kW = pkV x mA: The kW of the exposure can be any combination of mA and pkV allowed by the Radiographic and Filament Emission charts.

For Example: 80 pkV and 500 mA = 40 kW

Example: From chart SG-1560 150/180 Hz 3 Phase 0.8 Focal Spot, determine kW allowed with following known factors.
 Maximum number of exposures40
 Exposure time .050 second (50 milliseconds)
 Maximum Exposure per second4

From chart find 40 exposure block. On left side directly opposite this block under “Exposure Rate per Second” column, select 4 exposures per second. Find .050 seconds at top of chart. At intersection of exposure rate line and exposure time, find 60.9 kW.

0.4 Focal Spot 3 Ø 8 Degrees 50/60 Hz
0.4 Dimension Focale 3Ø 8 Degrés 50/60 Hz
0.4 Brennpunkt 3Ø 8 Grad 50/60 Hz
0.4 De Marcas Focales 3Ø 8 Grados 50/60 Hz

Caractéristiques Pour L'Angiographie CEI 60613
Angiographische Nennleistungen IEC 60613
Gradaciones Angiografica IEC 60613

Exposure rate per second	Tube load (kW) as a function of the exposure time (seconds) of the individual radiographs of the series															Number of exposures in series
	0.010	0.020	0.030	0.040	0.050	0.060	0.080	0.100	0.120	0.140	0.160	0.180	0.200	0.225	0.250	
1	16.2	16.2	16.0	15.9	15.8	15.6	15.4	15.3	15.1	15.0	14.8	14.7	14.6	14.5	14.4	10
2	16.2	16.2	16.0	15.8	15.7	15.6	15.3	15.1	15.0	14.8	14.7	14.5	14.4	14.3	14.2	
3	16.2	16.1	16.0	15.8	15.6	15.5	15.2	15.0	14.8	14.6	14.5	14.4	_____	_____	_____	
4	16.2	16.1	15.9	15.7	15.6	15.4	15.1	14.9	14.7	14.5	_____	_____	_____	_____	_____	
8	16.1	16.0	15.7	15.5	15.3	15.1	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	
15 30	16.0 15.9	15.8 15.5	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	
1	16.2	16.2	16.0	15.8	15.7	15.5	15.3	15.1	14.9	14.7	14.6	14.4	14.3	14.2	14.0	20
2	16.2	16.1	15.9	15.7	15.6	15.4	15.2	14.9	14.7	14.5	14.4	14.2	14.0	13.9	13.7	
3	16.2	16.1	15.9	15.7	15.5	15.3	15.0	14.8	14.5	14.3	14.1	14.0	_____	_____	_____	
4	16.2	16.1	15.8	15.6	15.4	15.2	14.9	14.6	14.4	14.2	_____	_____	_____	_____	_____	
8	16.1	15.9	15.6	15.3	15.1	14.9	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	
15 30	16.0 15.7	15.7 15.3	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	
1	16.2	16.1	15.9	15.7	15.5	15.3	15.0	14.8	14.5	14.3	14.1	13.9	13.8	13.6	13.4	40
2	16.2	16.1	15.8	15.6	15.4	15.2	14.9	14.6	14.3	14.1	13.9	13.7	13.5	13.2	13.0	
3	16.1	16.0	15.7	15.5	15.3	15.1	14.7	14.4	14.1	13.9	13.6	13.4	_____	_____	_____	
4	16.1	16.0	15.7	15.4	15.2	15.0	14.6	14.2	13.9	13.7	_____	_____	_____	_____	_____	
8	16.0	15.8	15.4	15.1	14.8	14.6	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	
15 30	15.9 15.6	15.5 15.0	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	
1	16.2	16.0	15.8	15.6	15.3	15.2	14.8	14.5	14.2	14.0	13.7	13.5	13.3	13.0	12.8	60
2	16.1	16.0	15.7	15.5	15.2	15.0	14.6	14.3	14.0	13.7	13.4	13.2	13.0	12.7	12.5	
3	16.1	15.9	15.6	15.4	15.1	14.9	14.5	14.1	13.8	13.5	13.2	12.9	_____	_____	_____	
4	16.1	15.9	15.6	15.3	15.0	14.8	14.3	13.9	13.6	13.3	_____	_____	_____	_____	_____	
8	16.0	15.7	15.3	14.9	14.6	14.3	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	
15 30	15.8 15.5	15.4 14.8	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	
1	16.1	16.0	15.7	15.4	15.2	15.0	14.6	14.2	13.9	13.6	13.3	13.1	12.8	12.6	12.3	80
2	16.1	15.9	15.6	15.3	15.1	14.8	14.4	14.0	13.7	13.4	13.1	12.8	12.5	12.2	12.0	
3	16.1	15.9	15.5	15.2	15.0	14.7	14.2	13.8	13.5	13.1	12.8	12.5	_____	_____	_____	
4	16.0	15.8	15.5	15.1	14.9	14.6	14.1	13.7	13.3	12.9	_____	_____	_____	_____	_____	
8	15.9	15.6	15.2	14.8	14.4	14.1	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	
15 30	15.8 15.4	15.3 14.7	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	
1	16.1	15.9	15.6	15.3	15.0	14.8	14.4	14.0	13.6	13.3	13.0	12.7	12.4	12.1	11.8	100
2	16.1	15.8	15.5	15.2	14.9	14.7	14.2	13.8	13.4	13.0	12.7	12.4	12.1	11.8	11.5	
3	16.0	15.8	15.4	15.1	14.8	14.5	14.0	13.6	13.2	12.8	12.5	12.1	_____	_____	_____	
4	16.0	15.7	15.4	15.0	14.7	14.4	13.9	13.4	13.0	12.6	_____	_____	_____	_____	_____	
8	15.9	15.5	15.1	14.7	14.3	13.9	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	
15 30	15.7 15.4	15.2 14.6	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	
1	16.0	15.7	15.4	15.0	14.7	14.4	13.9	13.4	12.9	12.5	12.2	11.8	11.5	11.2	10.8	150
2	16.0	15.7	15.3	14.9	14.6	14.3	13.7	13.2	12.7	12.3	11.9	11.6	11.2	10.9	10.5	
3	15.9	15.6	15.2	14.8	14.5	14.1	13.5	13.0	12.5	12.1	11.7	11.3	_____	_____	_____	
4	15.9	15.6	15.1	14.7	14.3	14.0	13.4	12.8	12.3	11.9	_____	_____	_____	_____	_____	
8	15.8	15.4	14.8	14.3	13.9	13.5	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	
15 30	15.6 15.2	15.0 14.3	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	

Note:

1. (kW) of Exposure Equals mA x kV.
For Example: 70 kV x 300 mA = 21 kW.
2. Exposures less than .010 seconds will have a kW rating same as .010 seconds.

Remarque:

1. (kW) en exposition égale kV x mA.
Par exemple: 70 kV x 300 mA = 21 kW.
2. Les expositions inférieures à 0.010 sec. ont les mêmes valeurs en kW que celles de 0.010 sec.

Anmerkungen:

1. (kW) der Belichtung is gleich mA x kV
Zum Beispiel: 70 kV x 300 mA = 21 kW.
2. Belichtungen von weniger als .010 Sekunden haben die gleichen kW Werte wie die von .010 Sekunden.

Nota:

1. (kW) De exposición se calcula multiplicando mA x kV-por ejemplo: 70 kV x 300 mA = 21 kW.
2. Para exposición de menos de .010 segundos, el resultado en (kW) sería lo mismo que el de .010 segundos.

Nominal anode input power for the anode heat content 70%. IEC 60613

Puissance calorifique nominale de l'anode: 70%, CEI 60613

Thermische Anoden bezugsleistung für eine speicherung von 70%. IEC 60613

Aproximadamente el poder de penetracion para obtener un almacenaje de calor del anodo de 70%. IEC 60613

0.8 Focal Spot 3Ø 8 Degrees 50/60 Hz
0,8 Dimension Focale 3Ø 8 Degrés 50/60 Hz
0.8 Brennpunkt 3Ø 8 Grad 50/60 Hz
0.8 De Marcas Focales 3Ø 8 Grados 50/60 Hz

Caractéristiques Pour L'Angiographie CEI 60613
Angiographische Nennleistungen IEC 60613
Gradaciones Angiografica IEC 60613

Exposure rate per second	Tube load (kW) as a function of the exposure time (seconds) of the individual radiographs of the series															Number of exposures in series
	0.010	0.020	0.030	0.040	0.050	0.060	0.080	0.100	0.120	0.140	0.160	0.180	0.200	0.225	0.250	
1	46.4	46.1	45.3	44.6	43.9	43.4	42.3	41.4	40.6	39.9	39.2	38.6	38.0	37.2	36.6	10
2	46.3	45.9	45.0	44.1	43.4	42.8	41.6	40.5	39.6	38.8	38.0	37.3	36.6	35.8	35.0	
3	46.1	45.7	44.6	43.7	42.9	42.2	40.9	39.7	38.7	37.8	36.9	36.1	_____	_____	_____	
4	46.0	45.4	44.3	43.3	42.4	41.6	40.2	39.0	37.9	36.9	_____	_____	_____	_____	_____	
8	45.6	44.7	43.3	42.0	40.9	39.9	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	
15 30	45.1 44.4	43.8 42.4	42.0	40.4	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	
1	46.2	45.8	44.9	44.0	43.2	42.5	41.3	40.2	39.2	38.3	37.4	36.6	35.9	35.0	34.2	20
2	46.1	45.5	44.4	43.4	42.6	41.8	40.4	39.1	38.0	36.9	36.0	35.1	34.3	33.3	32.5	
3	45.9	45.2	44.0	42.9	42.0	41.1	39.5	38.1	36.9	35.8	34.8	33.8	_____	_____	_____	
4	45.8	44.9	43.6	42.4	41.4	40.4	38.7	37.2	35.9	34.7	_____	_____	_____	_____	_____	
8	45.3	44.0	42.3	40.8	39.5	38.3	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	
15 30	44.6 43.5	42.7 40.7	40.6	38.7	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	
1	45.9	45.2	44.0	42.9	42.0	41.1	39.5	38.1	36.8	35.6	34.6	33.6	32.7	31.6	30.6	40
2	45.7	44.9	43.6	42.3	41.2	40.2	38.5	36.9	35.5	34.3	33.1	32.0	31.1	29.9	28.9	
3	45.6	44.5	43.1	41.7	40.5	39.5	37.5	35.9	34.4	33.0	31.8	30.7	_____	_____	_____	
4	45.4	44.2	42.6	41.2	39.9	38.7	36.7	34.9	33.3	31.9	_____	_____	_____	_____	_____	
8	44.8	43.1	41.1	39.3	37.7	36.3	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	
15 30	43.9 42.5	41.5 39.0	39.0	36.8	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	
1	45.7	44.7	43.3	42.0	40.8	39.8	37.9	36.3	34.8	33.4	32.2	31.1	30.1	28.9	27.8	60
2	45.5	44.3	42.8	41.3	40.1	38.9	36.9	35.1	33.5	32.1	30.8	29.6	28.6	27.4	26.2	
3	45.3	44.0	42.3	40.7	39.4	38.1	35.9	34.0	32.4	30.9	29.6	28.4	_____	_____	_____	
4	45.1	43.6	41.8	40.1	38.7	37.4	35.1	33.1	31.4	29.8	_____	_____	_____	_____	_____	
8	44.4	42.4	40.1	38.2	36.4	34.9	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	
15 30	43.4 41.8	40.7 37.9	37.9	35.5	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	
1	45.4	44.2	42.6	41.1	39.8	38.6	36.5	34.6	33.0	31.5	30.2	29.0	27.9	26.6	25.0	80
2	45.2	43.8	42.0	40.4	39.0	37.7	35.5	33.5	31.8	30.3	28.9	27.7	26.5	25.3	24.1	
3	45.0	43.4	41.5	39.8	38.3	36.9	34.5	32.5	30.7	29.1	27.7	26.5	_____	_____	_____	
4	44.8	43.1	41.0	39.2	37.6	36.2	33.7	31.5	29.7	28.1	_____	_____	_____	_____	_____	
8	44.1	41.8	39.3	37.2	35.3	33.7	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	
15 30	43.0 41.3	40.0 37.0	37.0	34.4	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	
1	45.1	43.7	41.9	40.3	38.8	37.5	35.2	33.2	31.4	29.8	28.5	27.2	25.0	22.2	20.0	100
2	44.9	43.3	41.3	39.6	38.0	36.6	34.2	32.1	30.3	28.7	27.2	25.9	24.8	22.2	20.0	
3	44.7	42.9	40.8	39.0	37.3	35.8	33.3	31.1	29.2	27.6	26.1	24.8	_____	_____	_____	
4	44.5	42.5	40.3	38.4	36.6	35.1	32.4	30.2	28.3	26.6	_____	_____	_____	_____	_____	
8	43.8	41.2	38.6	36.3	34.3	32.6	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	
15 30	42.7 40.8	39.4 36.3	36.2	33.5	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	
1	44.5	42.5	40.3	38.3	36.6	35.0	32.3	30.0	27.8	23.8	20.8	18.5	16.7	14.8	13.3	150
2	44.3	42.1	39.7	37.7	35.8	34.2	31.4	29.1	27.1	23.8	20.8	18.5	16.7	14.8	13.3	
3	44.0	41.7	39.2	37.0	35.1	33.4	30.6	28.2	26.2	23.8	20.8	18.5	_____	_____	_____	
4	43.8	41.3	38.7	36.4	34.5	32.7	29.8	27.4	25.3	23.6	_____	_____	_____	_____	_____	
8	43.1	40.0	37.0	34.4	32.3	30.4	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	
15 30	41.9 39.9	38.1 34.9	34.6	31.7	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	

Note:
1. (kW) of Exposure Equals mA x kV.
For Example: 70 kV x 300 mA = 21 kW.
2. Exposures less than .010 seconds will have a kW rating same as .010 seconds.

Remarque:
1. (kW) en exposition égale kV x mA.
Par exemple: 70 kV x 300 mA = 21 kW.
2. Les expositions inférieures à 0.010 sec. ont les mêmes valeurs en kW que celles de 0.010 sec.

Anmerkungen:
1. (kW) der Belichtung is gleich mA x kV
Zum Beispiel: 70 kV x 300 mA = 21 kW.
2. Belichtungen von weniger als .010 Sekunden haben die gleichen kW Werte wie die von .010 Sekunden.

Nota:
1. (kW) De exposición se calcula multiplicando mA x kV-por ejemplo: 70 kV x 300 mA = 21 kW.
2. Para exposicione de menos de .010 segundos, el resultado en (kW) seria lo mismo que el de .010 segundos.

Nominal anode input power for the anode heat content 70%. IEC 60613

Puissance calorifique nominale de l'anode: 70%, CEI 60613

Thermische Anoden bezugsleistung für eine speicherung von 70%. IEC 60613

Aproximadamente el poder de penetracion para obtener un almacenaje de calor del anodo de 70%. IEC 60613

0.4 Focal Spot 3Ø 8 Degrees 150/180 Hz
0.4 Dimension Focale 3Ø 8 Degrés 150/180 Hz
0.4 Brennpunkt 3Ø 8 Grad 150/180 Hz
0.4 De Marcas Focales 3Ø 8 Grados 150/180 Hz

Caractéristiques Pour L'Angiographie CEI 60613
Angiographische Nennleistungen IEC 60613
Gradaciones Angiografica IEC 60613

Exposure rate per second	Tube load (kW) as a function of the exposure time (seconds) of the individual radiographs of the series															Number of exposures in series
	0.010	0.020	0.030	0.040	0.050	0.060	0.080	0.100	0.120	0.140	0.160	0.180	0.200	0.225	0.250	
1	28.0	27.4	26.9	26.5	26.2	25.9	25.3	24.9	24.5	24.1	23.8	23.6	23.3	23.0	22.8	10
2	28.0	27.3	26.8	26.4	26.0	25.6	25.0	24.5	24.1	23.7	23.4	23.1	22.8	22.4	22.1	
3	27.9	27.2	26.7	26.2	25.8	25.4	24.8	24.2	23.7	23.3	22.9	22.6				
4	27.9	27.1	26.5	26.0	25.6	25.2	24.5	23.9	23.4	23.0						
8	27.7	26.8	26.1	25.5	24.9	24.5										
15	27.4	26.3	25.4	24.6												
30	26.9	25.4														
1	28.0	27.3	26.7	26.3	25.9	25.6	24.9	24.4	23.9	23.5	23.2	22.8	22.5	22.1	21.8	20
2	27.9	27.2	26.6	26.1	25.7	25.3	24.6	24.0	23.5	23.0	22.6	22.2	21.9	21.4	21.1	
3	27.8	27.0	26.4	25.9	25.4	25.0	24.3	23.6	23.0	22.5	22.1	21.7				
4	27.8	26.9	26.3	25.7	25.2	24.8	23.9	23.2	22.6	22.1						
8	27.6	26.5	25.7	25.0	24.4	23.8										
15	27.2	25.9	24.8	24.0												
30	26.5	24.8														
1	27.8	27.1	26.4	25.9	25.5	25.0	24.3	23.6	23.0	22.5	22.0	21.6	21.2	20.7	20.3	40
2	27.8	26.9	26.3	25.7	25.2	24.7	23.9	23.1	22.5	21.9	21.4	20.9	20.5	20.0	19.5	
3	27.7	26.8	26.1	25.5	24.9	24.4	23.5	22.7	22.0	21.4	20.8	20.3				
4	27.6	26.7	25.9	25.2	24.6	24.1	23.1	22.3	21.6	20.9						
8	27.4	26.2	25.2	24.4	23.7	23.0										
15	26.9	25.4	24.2	23.2												
30	26.2	24.1														
1	27.7	26.9	26.2	25.6	25.0	24.5	23.7	22.9	22.2	21.6	21.1	20.5	20.1	19.5	19.0	60
2	27.7	26.7	26.0	25.3	24.7	24.2	23.2	22.4	21.7	21.0	20.4	19.9	19.4	18.8	18.2	
3	27.6	26.6	25.8	25.1	24.5	23.9	22.8	22.0	21.2	20.5	19.9	19.3				
4	27.5	26.5	25.6	24.8	24.2	23.6	22.5	21.5	20.7	20.0						
8	27.2	25.9	24.9	24.0	23.2	22.4										
15	26.7	25.1	23.8	22.7												
30	25.9	23.6														
1	27.6	26.7	25.9	25.2	24.6	24.1	23.1	22.2	21.5	20.8	20.2	19.6	19.1	18.5	17.9	80
2	27.6	26.5	25.7	25.0	24.3	23.7	22.7	21.7	20.9	20.2	19.6	19.0	18.4	17.8	17.2	
3	27.5	26.4	25.5	24.7	24.0	23.4	22.3	21.3	20.4	19.7	19.0	18.4				
4	27.4	26.2	25.3	24.5	23.8	23.1	21.9	20.9	20.0	19.2						
8	27.1	25.7	24.6	23.6	22.7	21.9										
15	26.6	24.8	23.4	22.2												
30	25.7	23.3														
1	27.5	26.5	25.7	24.9	24.3	23.6	22.6	21.6	20.8	20.0	19.4	18.8	18.2	17.5	16.9	100
2	27.5	26.3	25.4	24.7	23.9	23.3	22.1	21.1	20.3	19.5	18.8	18.1	17.5	16.9	16.3	
3	27.4	26.2	25.2	24.4	23.6	23.0	21.7	20.7	19.8	19.0	18.2	17.6				
4	27.3	26.1	25.0	24.2	23.4	22.6	21.4	20.3	19.3	18.5						
8	27.0	25.5	24.3	23.2	22.3	21.5										
15	26.5	24.6	23.1	21.8												
30	25.5	23.0														
1	27.3	26.1	25.0	24.2	23.4	22.6	21.3	20.2	19.3	18.4	17.6	16.9	16.3	14.8	13.3	150
2	27.2	25.9	24.8	23.9	23.0	22.3	20.9	19.8	18.8	17.9	17.1	16.4	15.7	14.8	13.3	
3	27.1	25.7	24.6	23.6	22.7	21.9	20.5	19.4	18.3	17.4	16.6	15.9				
4	27.1	25.6	24.4	23.4	22.5	21.6	20.2	19.0	17.9	17.0						
8	26.7	25.0	23.6	22.4	21.4	20.5										
15	26.2	24.1	22.4	21.0												
30	25.2	22.4														

Note:

1. (kW) of Exposure Equals mA x kV.
For Example: 70 kV x 300 mA = 21 kW.
2. Exposures less than .010 seconds will have a kW rating same as .010 seconds.

Remarque:

1. (kW) en exposition égale kV x mA.
Par exemple: 70 kV x 300 mA = 21 kW.
2. Les expositions inférieures à 0.010 sec. ont les mêmes valeurs en kW que celles de 0.010 sec.

Anmerkungen:

1. (kW) der Belichtung ist gleich mA x kV.
Zum Beispiel: 70 kV x 300 mA = 21 kW.
2. Belichtungen von weniger als .010 Sekunden haben die gleichen kW Werte wie die von .010 Sekunden.

Nota:

1. (kW) De exposición se calcula multiplicando mA x kV-por ejemplo: 70 kV x 300 mA = 21 kW.
2. Para exposición de menos de .010 segundos, el resultado en (kW) sería lo mismo que el de .010 segundos.

Nominal anode input power for the anode heat content 70%. IEC 60613

Puissance calorifique nominale de l'anode: 70%, CEI 60613

Thermische Anoden bezugsleistung für eine speicherung von 70%. IEC 60613

Aproximadamente el poder de penetracion para obtener un almacenaje de calor del anodo de 70%. IEC 60613

0.8 Focal Spot 3Ø 8 Degrees 150/180 Hz
0,8 Dimension Focale 3Ø 8 Degrés 150/180 Hz
0.8 Brennpunkt 3Ø Grad 150/180 Hz
0.8 De Marcas Focales 3Ø 8 Grados 150/180 Hz

Caractéristiques Pour L'Angiographie CEI 60613
Angiographische Nennleistungen IEC 60613
Gradaciones Angiografica IEC 60613

Exposure rate per second	Tube load (kW) as a function of the exposure time (seconds) of the individual radiographs of the series															Number of exposures in series
	0.010	0.020	0.030	0.040	0.050	0.060	0.080	0.100	0.120	0.140	0.160	0.180	0.200	0.225	0.250	
1	79.5	76.5	74.3	72.5	70.9	69.4	66.9	64.8	62.8	61.1	59.5	58.1	56.7	55.1	53.7	10
2	79.1	75.8	73.4	71.3	69.5	67.9	65.0	62.6	60.4	58.5	56.7	55.1	53.7	52.0	50.4	
3	78.8	75.2	72.5	70.2	68.2	66.4	63.3	60.7	58.3	56.2	54.4	52.7	_____	_____	_____	
4	78.4	74.6	71.6	69.2	67.0	65.1	61.7	58.9	56.4	54.3	_____	_____	_____	_____	_____	
8	77.3	72.7	69.0	66.0	63.3	61.0	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	
15	75.9	70.2	65.8	62.1	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	
30	73.9	66.8	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	
1	79.0	75.6	73.1	70.9	69.0	67.3	64.3	61.7	59.4	57.4	55.5	53.8	52.2	50.4	48.7	20
2	78.5	74.8	71.9	69.5	67.4	65.5	62.1	59.2	56.7	54.4	52.4	50.6	48.9	47.0	45.3	
3	78.1	74.0	70.9	68.2	65.9	63.8	60.1	57.0	54.3	51.9	49.8	47.9	_____	_____	_____	
4	77.7	73.3	69.8	67.0	64.4	62.2	58.3	55.0	52.2	49.7	_____	_____	_____	_____	_____	
8	76.3	70.8	66.6	63.0	60.0	57.3	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	
15	74.3	67.6	62.3	58.1	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	
30	71.3	62.7	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	
1	78.1	74.1	70.9	68.2	65.9	63.8	60.1	56.9	54.1	51.6	49.4	47.4	45.6	43.6	41.7	40
2	77.6	73.1	69.7	66.7	64.1	61.8	57.7	54.3	51.4	48.8	46.5	44.4	42.6	40.5	38.6	
3	77.1	72.2	68.4	65.2	62.4	59.9	55.7	52.1	49.0	46.3	44.0	41.9	_____	_____	_____	
4	76.6	71.4	67.3	63.9	60.9	58.3	53.8	50.1	46.9	44.2	_____	_____	_____	_____	_____	
8	74.9	68.5	63.6	59.5	56.0	52.9	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	
15	72.5	64.6	58.6	53.8	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	
30	68.6	58.7	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	
1	77.3	72.7	69.0	65.9	63.1	60.7	56.5	52.9	49.8	47.2	44.8	42.7	40.7	37.0	33.3	60
2	76.8	71.7	67.7	64.3	61.3	58.7	54.2	50.5	47.3	44.5	42.1	40.0	38.0	35.9	33.3	
3	76.2	70.7	66.4	62.8	59.7	56.9	52.2	48.3	45.1	42.3	39.8	37.7	_____	_____	_____	
4	75.7	69.8	65.2	61.4	58.1	55.2	50.4	46.4	43.1	40.3	_____	_____	_____	_____	_____	
8	73.9	66.8	61.3	56.9	53.1	49.9	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	
15	71.2	62.6	56.2	51.1	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	
30	66.9	56.2	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	
1	76.6	71.3	67.2	63.7	60.7	58.0	53.4	49.5	46.3	43.5	39.1	34.7	31.2	27.8	25.0	80
2	76.0	70.3	65.9	62.1	58.9	56.1	51.2	47.3	43.9	41.1	38.6	34.7	31.2	27.8	25.0	
3	75.4	69.3	64.6	60.7	57.3	54.3	49.3	45.3	41.9	39.0	36.6	34.4	_____	_____	_____	
4	74.9	68.4	63.4	59.3	55.7	52.7	47.6	43.5	40.1	37.2	_____	_____	_____	_____	_____	
8	72.9	65.3	59.5	54.8	50.8	47.5	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	
15	70.2	61.0	54.2	49.0	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	
30	65.6	54.4	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	
1	75.8	70.0	65.5	61.7	58.4	55.5	50.6	46.6	41.7	35.7	31.2	27.8	25.0	22.2	20.0	100
2	75.2	69.0	64.2	60.2	56.7	53.7	48.6	44.5	41.1	35.7	31.2	27.8	25.0	22.2	20.0	
3	74.6	68.1	62.9	58.7	55.1	52.0	46.8	42.6	39.2	35.7	31.2	27.8	_____	_____	_____	
4	74.1	67.1	61.7	57.3	53.6	50.4	45.1	40.9	37.5	34.7	_____	_____	_____	_____	_____	
8	72.1	63.9	57.8	52.9	48.9	45.4	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	
15	69.2	59.6	52.6	47.2	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	
30	64.5	52.9	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	
1	74.1	67.1	61.7	57.2	53.5	50.2	41.7	33.3	27.8	23.8	20.8	18.5	16.7	14.8	13.3	150
2	73.4	66.1	60.4	55.8	51.9	48.6	41.7	33.3	27.8	23.8	20.8	18.5	16.7	14.8	13.3	
3	72.8	65.1	59.2	54.4	50.5	47.1	41.6	33.3	27.8	23.8	20.8	18.5	_____	_____	_____	
4	72.2	64.2	58.1	53.2	49.1	45.7	40.2	33.3	27.8	23.8	_____	_____	_____	_____	_____	
8	70.2	61.0	54.3	49.0	44.8	41.2	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	
15	67.2	56.7	49.2	43.7	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	
30	62.2	49.9	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	

Note:
1. (kW) of Exposure Equals mA x kV.
For Example: 70 kV x 300 mA = 21 kW.
2. Exposures less than .010 seconds will have a kW rating same as .010 seconds.

Remarque:
1. (kW) en exposition égale kV x mA.
Par exemple: 70 kV x 300 mA = 21 kW.
2. Les expositions inférieures à 0.010 sec. ont les mêmes valeurs en kW que celles de 0.010 sec.

Anmerkungen:
1. (kW) der Belichtung is gleich mA x kV
Zum Beispiel: 70 kV x 300 mA = 21 kW.
2. Belichtungen von weniger als .010 Sekunden haben die gleichen kW Werte wie die von .010 Sekunden.

Nota:
1. (kW) De exposición se calcula multiplicando mA x kV-por ejemplo: 70 kV x 300 mA = 21 kW.
2. Para exposicion de menos de .010 segundos, el resultado en (kW) seria lo mismo que el de .010 segundos.

Nominal anode input power for the anode heat content 70%. IEC 60613


Puissance calorifique nominale de l'anode: 70%, CEI 60613

Thermische Anoden bezugsleistung für eine speicherung von 70%. IEC 60613

Aproximadamente el poder de penetracion para obtener un almacenaje de calor del anodo de 70%. IEC 60613


3 Ø FULL WAVE

Abaques d'Émissions des Filaments CEI 60613
Heizfadenemissionsdiagramm IEC 60613
Curvas de Emisión de los Filamentos IEC 60613

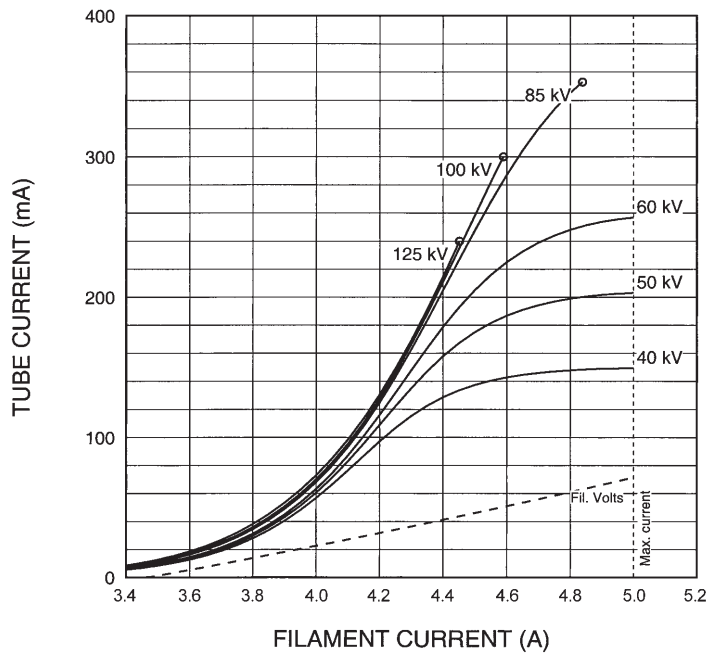

THREE PHASE EMISSION ($\pm .15$ A)
SG-1560 0.4

FILAMENT VOLTAGE (V)

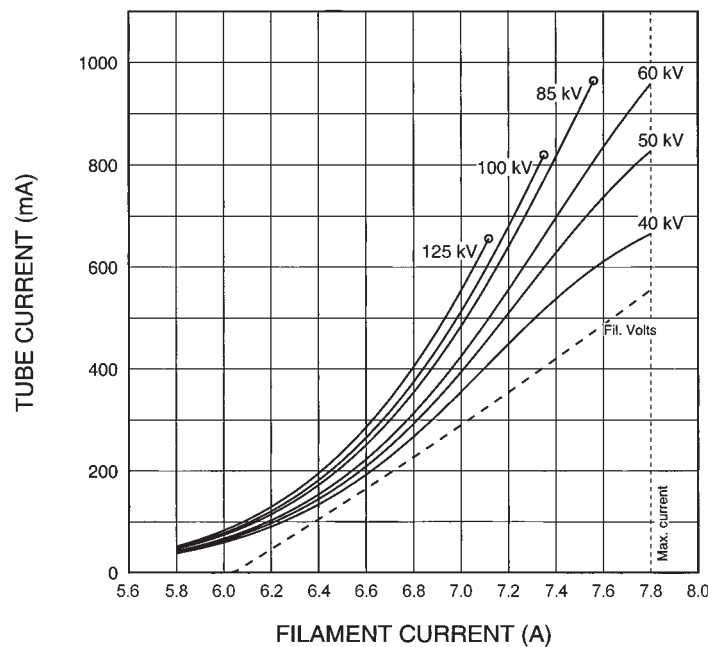

THREE PHASE EMISSION ($\pm .15$ A)
SG-1560 0.8

FILAMENT VOLTAGE (V)


Note: When using these emission curves for trial exposures, refer to the power rating curves shown for maximum kV, tube emission, filament current, exposure time, and target speed.

Remarque: Lors de l'utilisation de ces abaques pour des expositions d'essai, référez-vous aux courbes maximales de kV, d'émission du filament, de temps d'exposition et de vitesse de rotation.

Anmerkung: Wenn Sie diese Emissionskurven für Testaufnahmen verwenden, beziehen Sie sich hierbei auf die entsprechenden Nennleistungskurven für max. kV-Werte, Röhrenemission, Heizstrom, und Anodendrehzahl.

Nota: Si utiliza estas curvas de emisión para exposiciones de prueba, refiérase a las curvas de gradación de potencia para el máximo de kV, tubo de emisión, corriente en los filamentos, tiempo de exposición, y a las curvas de velocidad del objetivo.

Abaques d' Échauffement et de Refroidissement de L'Anode
Anoden Aufheiz - und Abkühlkurven
Curvas de Calentamiento y Enfriamiento del Anodo

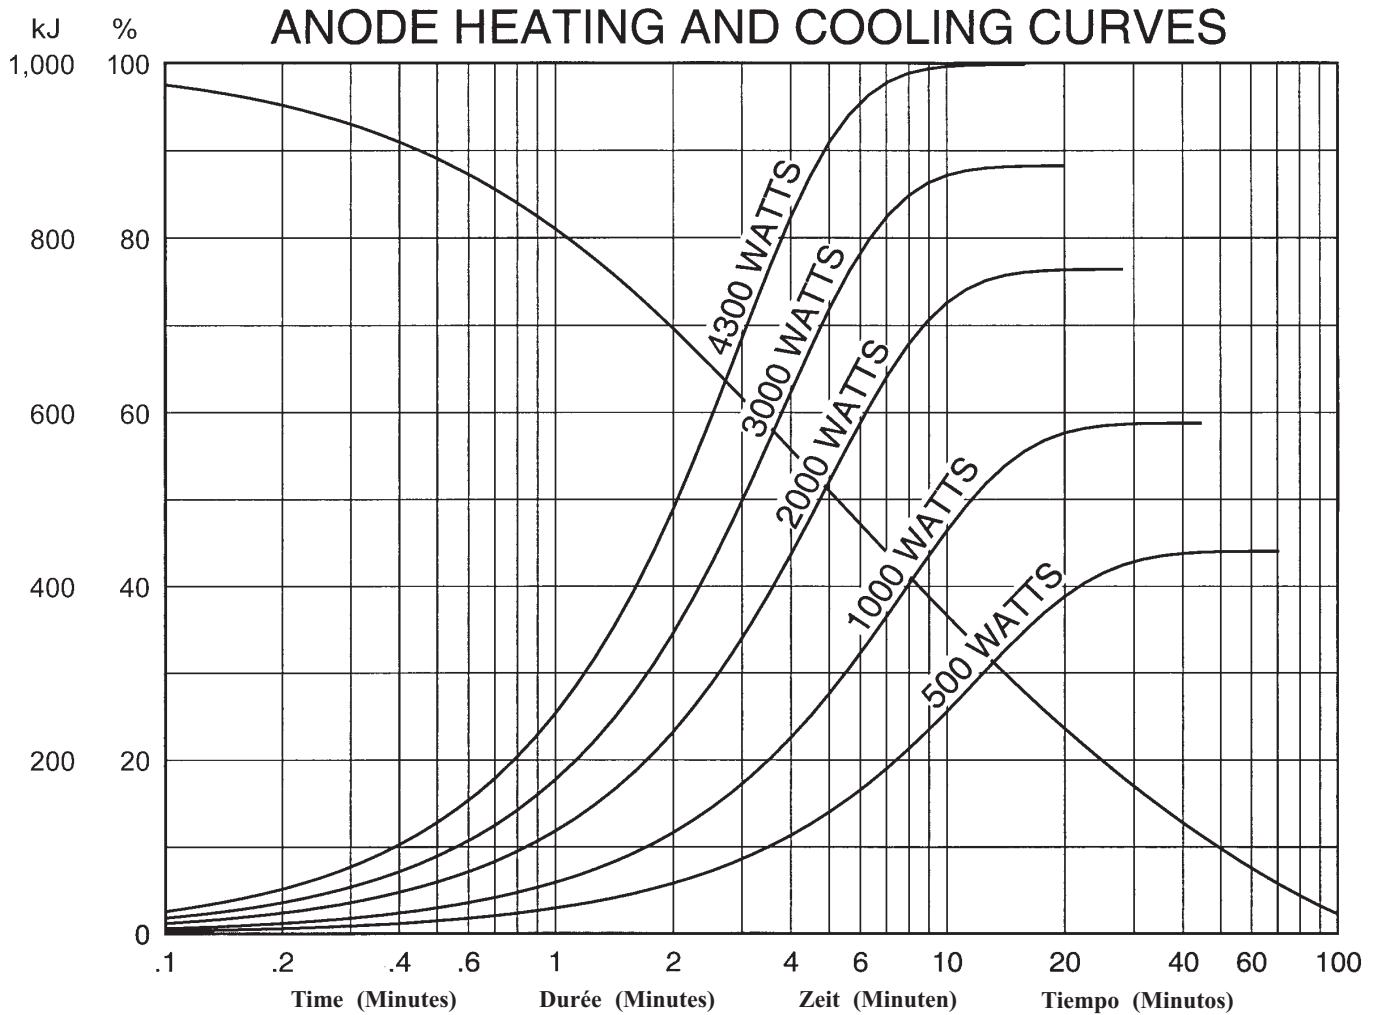

VARIAN
medical systems

**X-RAY
PRODUCTS**

Salt Lake City, UT
Charleston, SC

1-801-972-5000
1-843-767-3005

www.varian.com